

# Les Surveillances du CH de cahors par l'EOH



Alicia BERTHOUIN , Jody DELPEYROUX, Annabel DELPECH  
Infirmières à l'EOH



Olivier PICHENOT : Pharmacien hygiéniste

# SOMMAIRE

- **Présentation de l'hôpital de Cahors**
- **Contrôle des eaux**
- **Contrôles des surfaces**
- **Contrôle de la qualité de l'air**
- **Prélèvement bactériologique sur endoscopes**
- **Contrôles bactériologiques du laveur désinfecteur endoscopes WD 440 WASSENBURG**
- **Prélèvements bactériologiques sur enceinte de stockage des endoscopes thermosensibles WASSERBURG dry 300**




# Présentation de l'hôpital de Cahors



Le Centre Hospitalier de Cahors est le CH support du Groupement Hospitalier Territorial du Lot.

Les services de l'établissement sont organisés en différents pôles :

- pôle chirurgie avec un bloc opératoire de 9 salles
- pôle médecine
- pôle mère/enfant
- pôle urgences/réanimation
- pôle médico-technique

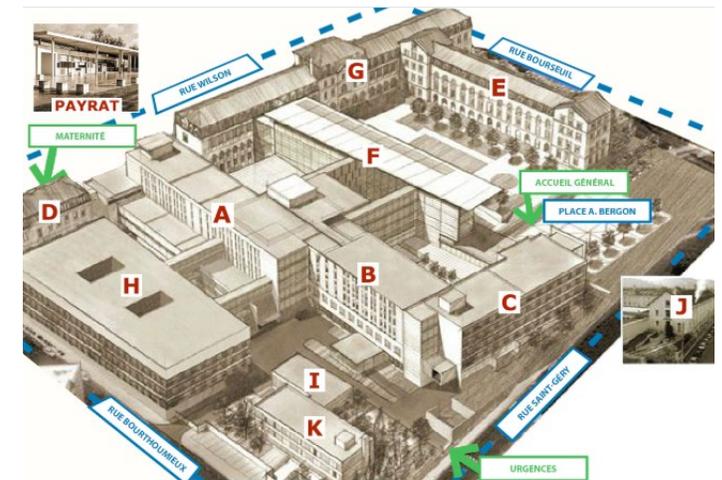

Le centre hospitalier compte 321 lits



# Contrôle des eaux



## LES DONNEES :

EOH sur 3 jours J1, J2 et J3

### Eaux du réseau (2024)

- Potabilité + Soins standard avec ou sans Pseudomonas  
⇒ Sur 229 prélèvements -> 30 % non-conformes
- Eaux bactériologiquement maîtrisées  
⇒ Sur 20 prélèvements -> 20 % non-conformes (sans atteinte du seuil d'action)
- Eaux chaude sanitaire (Légionnelles)  
⇒ Sur 54 prélèvements -> 7 % non-conformes (sans Pneumophila)

## LES DIFFICULTES


- Brise jets
- Réseau de l'eau
- Ancienneté des bâtiments
- Purges
- Difficultés d'accès

## QUELLE CONDUITE ?

- Prendre en compte la non-conformité ?
- Mettre des filtres ?
- Refaire un contrôle ?



# Contrôle des surfaces

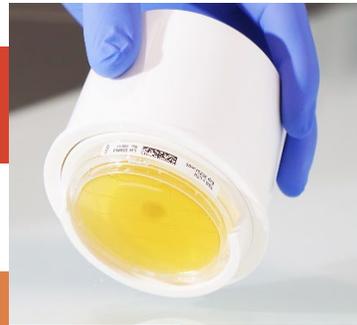


## LES DONNEES

- 1 fois par trimestre
- 1h après le bio nettoyage du service
- Chronologie de prélèvement défini en fonction de l'activité du service
- Résultats conformes malgré quelque points ponctuellement non conforme.

## LES DIFFICULTEES

- Sur 28 prélèvements en 2024, 17 non conformes soit 61 % en SSPI , Récurrent car lieu de circulation et post mal définit

### Résultats surfaces Salles de Bloc 2024

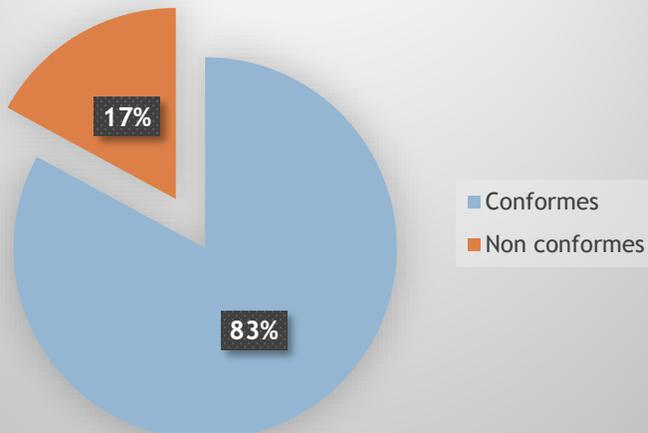

## QUELLE CONDUITE?

- Affiche des résultats par trimestre
- Document partager



# Contrôle DE LA QUALITE DE L'AIR

## LES DONNEES

- L'aéro-biocontamination → tous les semestres.
- Le contrôle particulaire → trimestriel (appareil appartenant au service)
- Le bloc → neuf centrales pour neuf salles
- Collaboration avec agent technique pour changement des filtres.




## LES DIFFICULTES

- Présence de moisissures à la pharmacie et stérilisation

## QUELLE CONDUITE ?

- Document partagé
- Qui fait le nettoyage des grilles de ventilation?

## Résultats annuel prélèvements d'air 2024

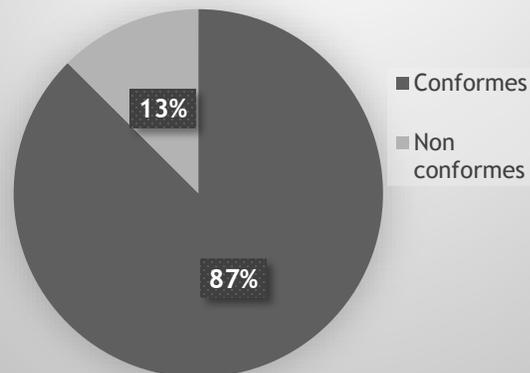

# Prélèvement bactériologique sur endoscopes

## LES DONNEES

- Dans une salle du bloc
- Après 6h minimum de stockage
- Conformité : 90 %

6% des non-conformités en seuil d'alerte



## LES DIFFICULTEES

- Contrainte de timing important
- Turn- over personnel
- Besoin d'être 2 pour les prélèvements

## QUELLE CONDUITE?

- Dossier partager
- Dossier SAV



# Contrôles bactériologiques des laveurs désinfecteurs d'endoscopes WD 440 Wassenburg

## LES DONNÉES

- Mise en pause du programme
- Intervalle d'1 semaine entre 2 laveurs



## LES DIFFICULTÉES

- Contrainte de timing important
- Filtres

## QUELLE CONDUITE ?

- Respect réglementation prélèvement en amont des filtres ? Intérêt?
- Lors de maintenance, séquestration laveurs? Ou bronchoscopes lavés manuellement?



# Prélèvements bactériologiques sur enceintes de stockage des endoscopes thermosensibles Wassenburg

## LES DONNÉES

- Après 7 jours de stockage en ESET X2
- Surveillances air + surfaces (faites à part)



## LES DIFFICULTÉES

- Peu d'appareils
- Activité importante
- Appareils vieillissants
- Les médecins ont appareils dit « favoris »
- Entretien des Connectiques X2 ESET non clair

## QUELLE CONDUITE ?

- Prélèvements lors de baisse d'activité
- Entretien des connectiques ?



# Des Questions ?

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

